

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ОСТ 26.260.472-2000

УСТРОЙСТВА ДЛЯ УСТАНОВКИ
ПРИБОРОВ ИЗМЕРЕНИЯ И
ОТБОРА ДАВЛЕНИЯ
Общие технические требования


УТВЕРЖДАЮ

Председатель ТК 260

"Оборудование химическое и
нефтеперерабатывающее"

В.А.Заваров

2002 г.

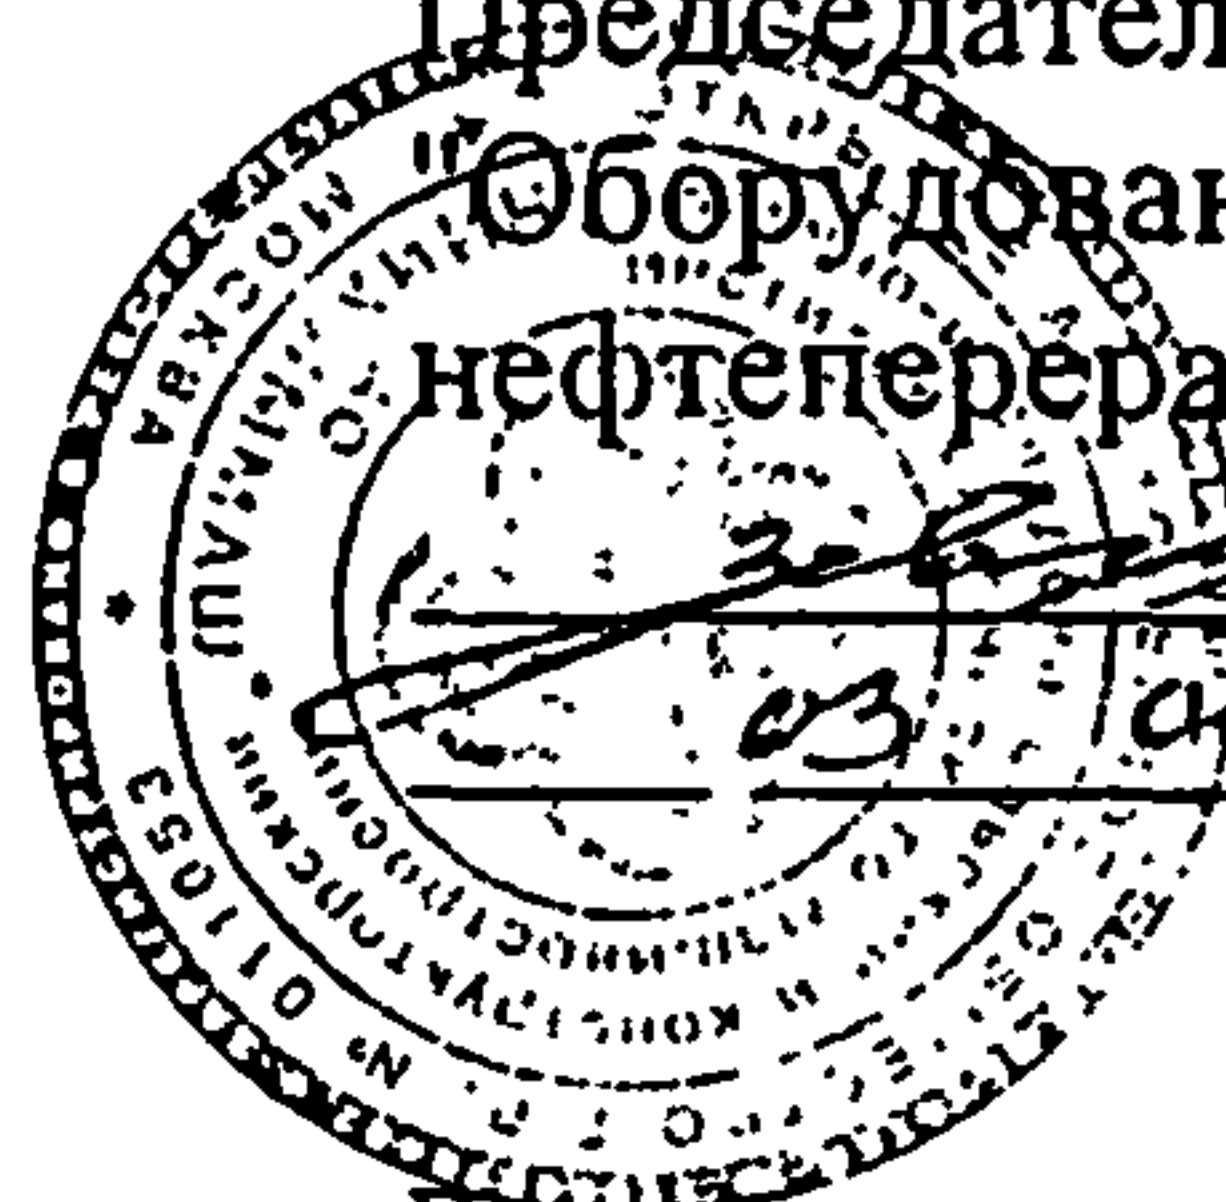

Дата введения 2002.04.01

Таблица 1 стр.139, 140 в графе "Наименование" изменить:

- "клапан ВНИЛ.49111.011-25" на "клапан ВНИЛ.491116.011-25"
- "клапан ВНИЛ.49111.011-09" на "клапан ВНИЛ.491116.011-09".

Таблица 1 стр.140 изменить в графах "Исполнение по материалам"
для клапана ВНИЛ.491116.011-25:

- в графе 5 "Ст35" на "—"
 - в графе 6 "—" на "12Х18Н10Т";
- для клапана ВНИЛ.491116.011-09:
- в графе 5 "—" на "Ст35"
 - в графе 6 "12Х18Н10Т" на "—"

ОАО "НИИХИММАШ"

Зарегистрировано № 199 2002-04-03

Заместитель Генерального директора
по научно-производственной деятельности

В.В.Раков

