

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ОСТ 26.260.468-2000

УСТРОЙСТВА ДЛЯ УСТАНОВКИ  
ПРИБОРОВ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ  
На Ру 4,0 и 16,0 МПа  
(с двумя клапанами ВНИЛ)  
Конструкция и размеры


УТВЕРЖДАЮ

Председатель ТК 260

Оборудование химическое и  
нефтеперерабатывающее"

В.А.Заваров

2002 г.

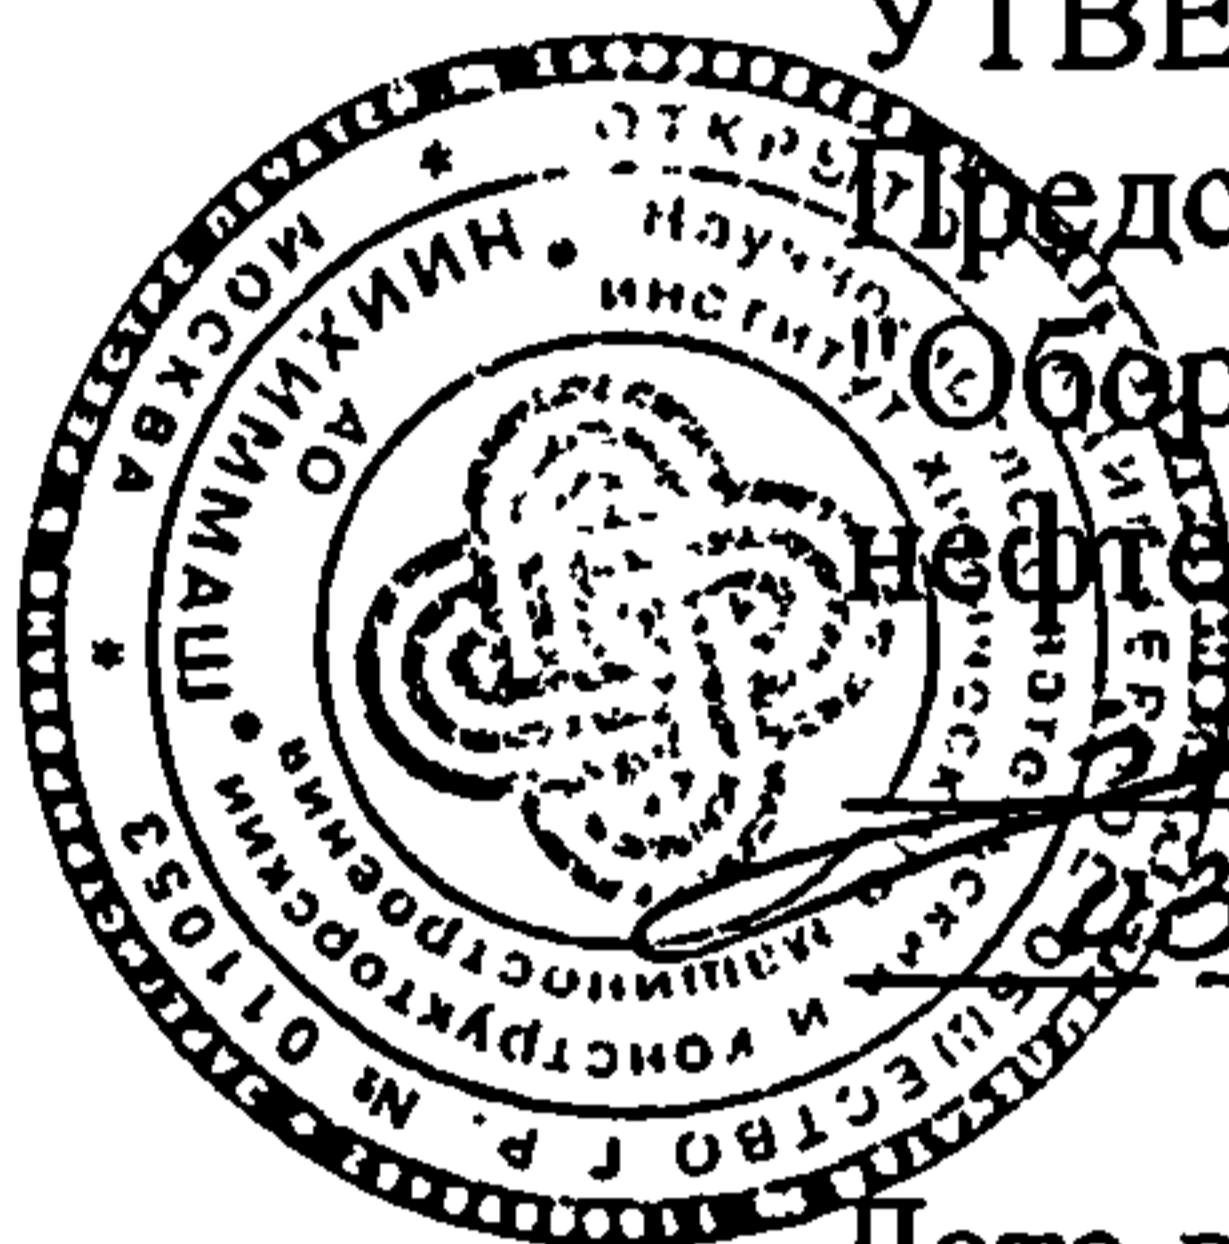

Дата введения 2002.04.01

Исполнение 1 стр.3, исполнение 5 стр.6, исполнение 9 стр.9,  
исполнение 13 стр.12 обозначение клапана изложить в новой редакции:  
"клапан DN10, ВНИЛ.491116.011-09, M22x1,5 ТУ 3742-008-31688214 или  
клапан DN10, ВНИЛ.491116.011-25, M22x1,5 ТУ 3742-008-31688214".

Стр.9 ввести надпись "Рисунок 9".

Генеральный директор ДАО ЦКБН

Ю.А.Кашицкий

Главный инженер ДАО ЦКБН

Б.С.Палей

Зав.отделом стандартизации  
и сертификации

Г.Н.Бекетов

Вед.инженер отдела № 8

Л.З.Федюшкина

Вед.инженер отдела № 8

Н.Н.Макарова

Инженер I кат.отдела № 8

Е.Д.Егорова

ОАО "НИИХИММАШ"

Зарегистрировано № 198 2002-04-03

Заместитель Генерального директора  
по научно-производственной деятельности

В.В.Раков

