

Изменение № 5 ГОСТ 10782—85 **Буылки стеклянныа для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов. Технические условия**

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 25 от 26.05.2004)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 4958

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, GE, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Вводная часть. Третий абзац исключить.

Пункт 1.2 изложить в новой редакции (кроме чертежей); дополнить чертежом — 12а (см. с. 44):

«1.2 Форма, основные размеры, вместимость и масса буыллок должны соответствовать указанным на черт. 1—12а, горловин — на черт. 13, 14.

Примечание. Внутренний диаметр горловин всех буыллок должен быть обеспечен на глубину не менее 5 мм».

Пункт 2.3. Заменить слова: «черт. 1—12» на «черт. 1—12а».

Пункты 2.17, 4.17, 4.18. Заменить ссылку: ГОСТ 20790—82 на ГОСТ 20790—93.


Пункт 3.3. Ссылку на ГОСТ 18242—72 дополнить знаком сноски: *; дополнить сноской:

«* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 50779.71—99».

(Продолжение см. с. 44)

(Продолжение изменения № 5 к ГОСТ 10782—85)

Тип II

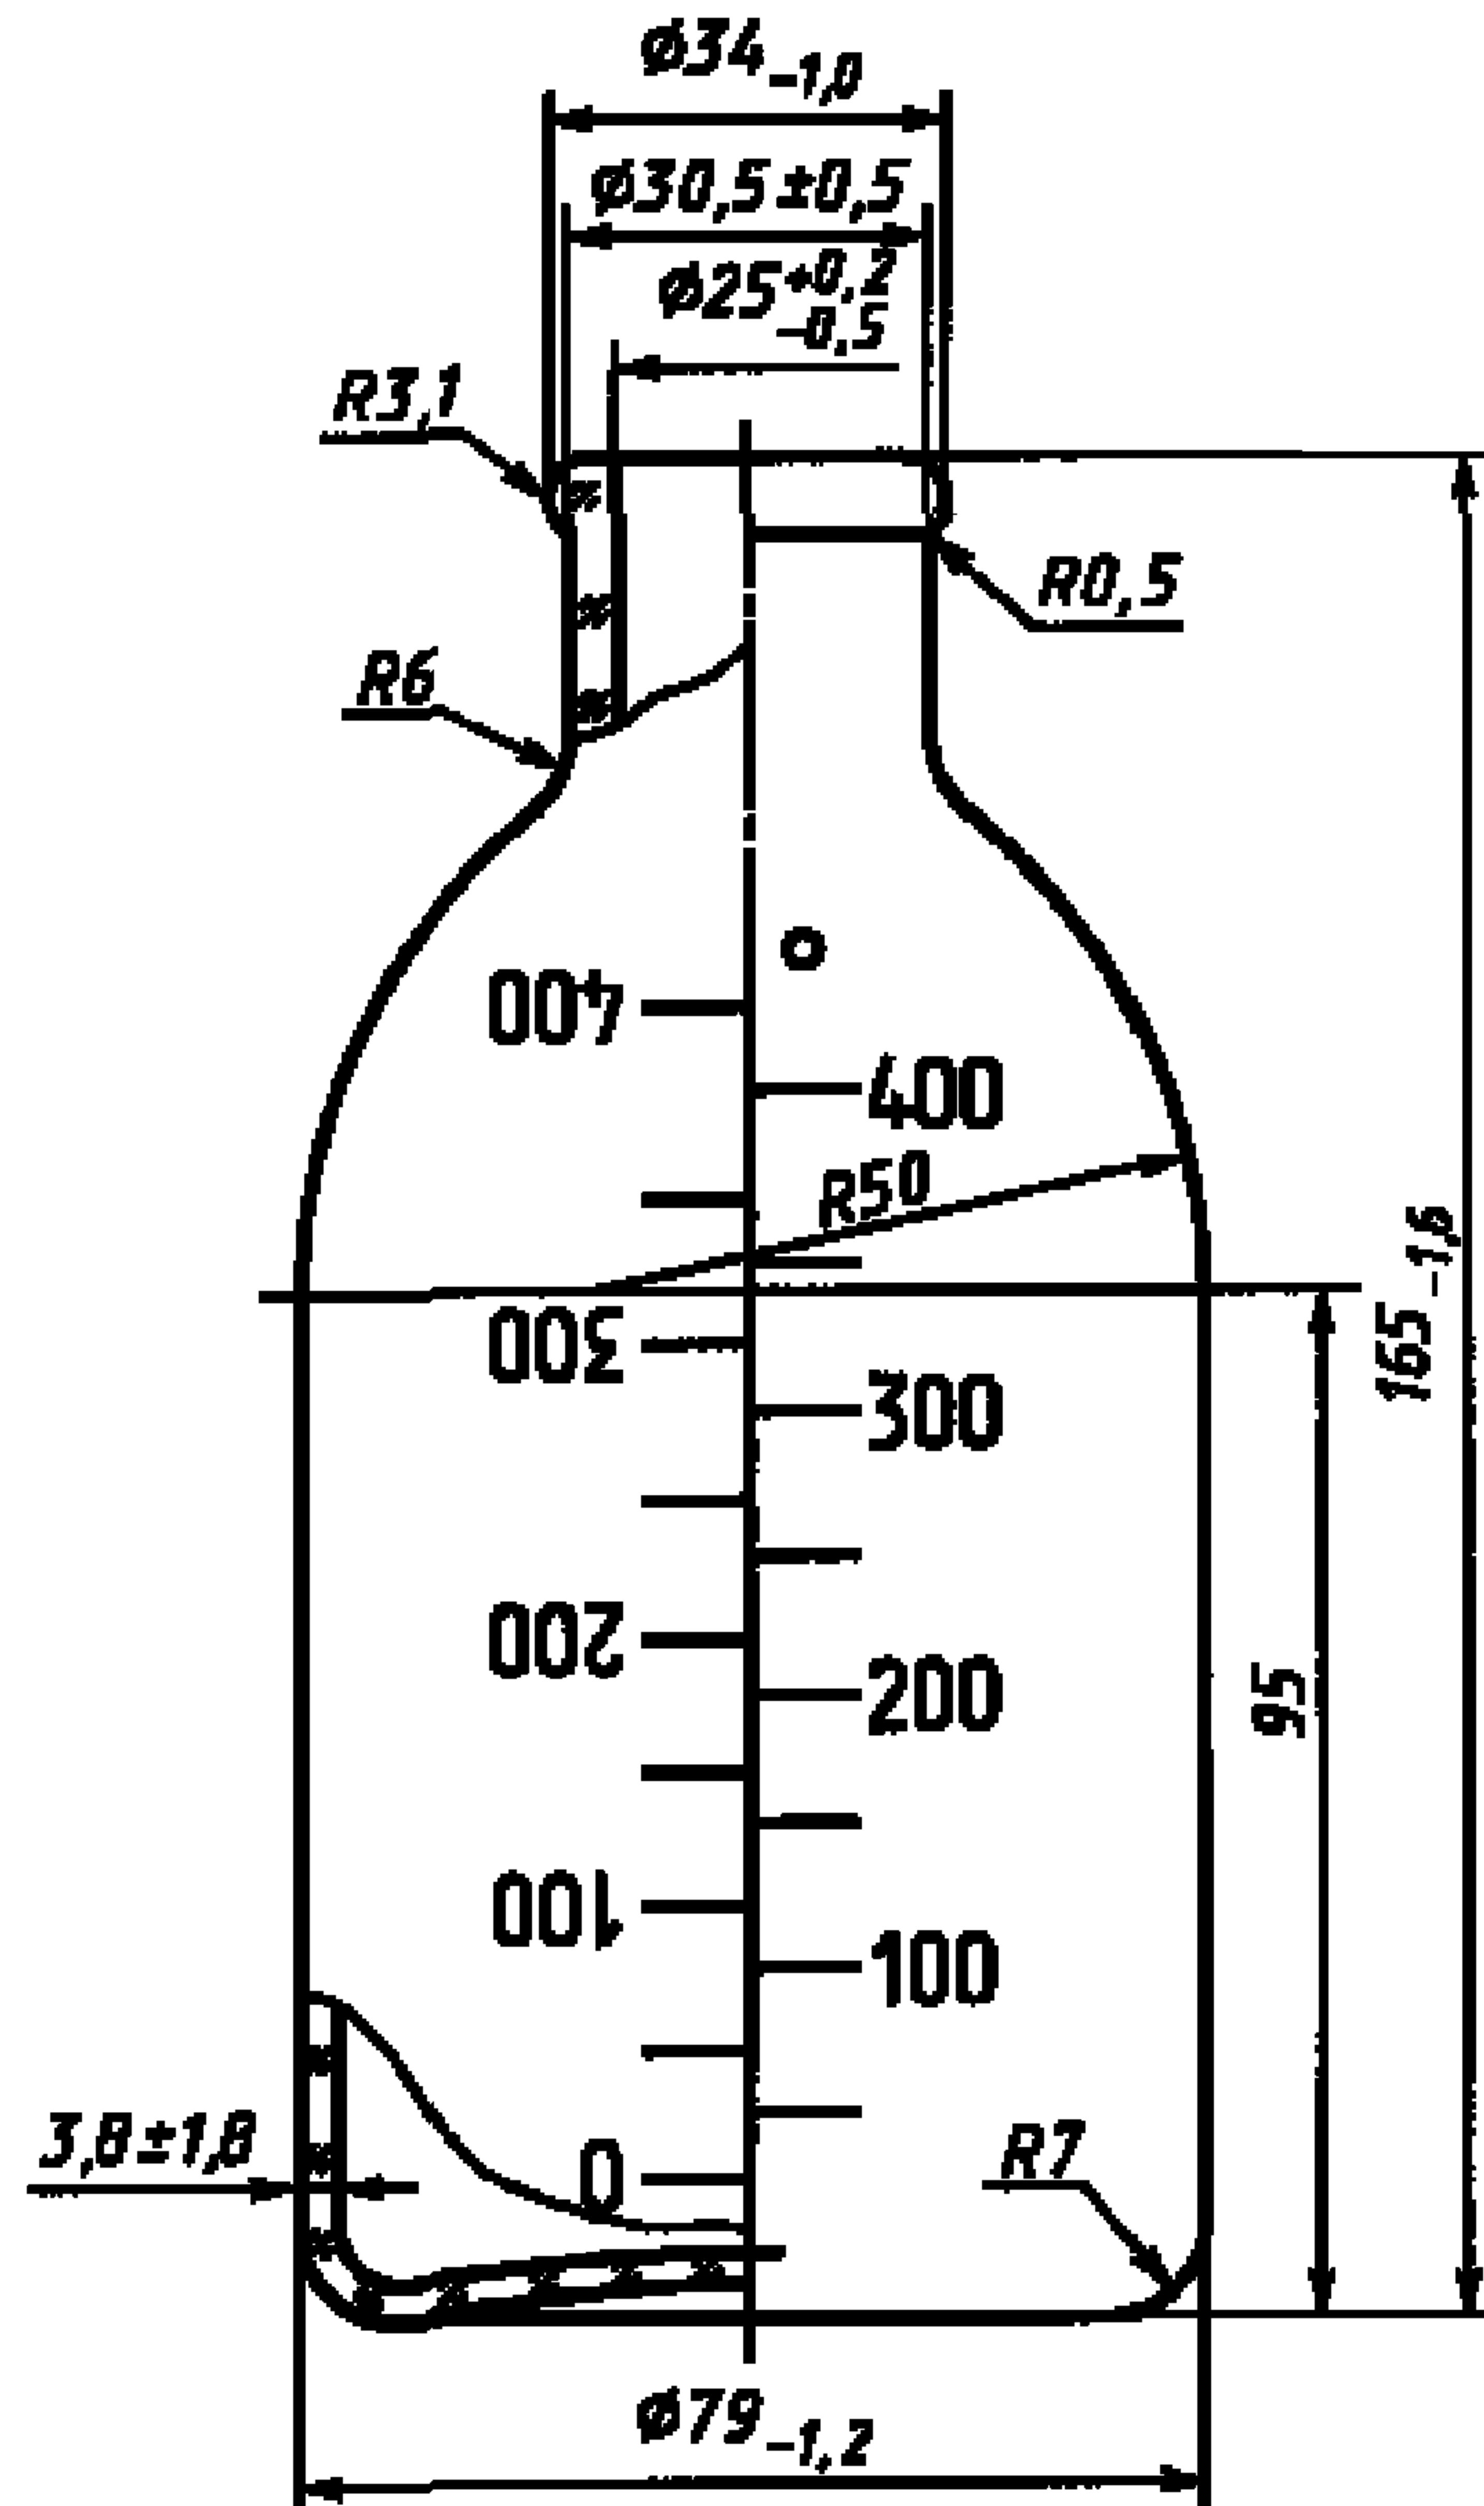

Номинальная вместимость, см^3 — 450.

Полная вместимость, см^3 — 510.

Масса бутылки, г, не более — 300.

Черт. 12а

(Продолжение см. с. 45)

(Продолжение изменения № 5 к ГОСТ 10782—85)

Пункт 4.1. Заменить ссылки: ГОСТ 166—60 на ГОСТ 166—89, ГОСТ 164—80 на ГОСТ 164—90.

Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 24980—81 на ГОСТ 24980—92.

Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 19809—74 на ГОСТ 19809—85.

Пункт 4.4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 1341—84 на ГОСТ 1341—97.

Пункт 4.5. Заменить ссылку: ГОСТ 380—88 на ГОСТ 380—94.

Пункт 4.9. Заменить ссылку: ГОСТ 164—80 на ГОСТ 164—90.

Пункт 4.11. Заменить ссылку: ГОСТ 166—80 на ГОСТ 166—89.

Пункт 4.12. Заменить ссылку: ГОСТ 11951—82 на ГОСТ 11358—89.

Пункт 4.13. Заменить ссылку: ГОСТ 7329—74 на ГОСТ 7329—91.

Пункт 4.14. Заменить ссылку: ГОСТ 13903—81 на ГОСТ 13903—93.

Пункт 4.16. Заменить ссылки: ГОСТ 23676—79 и ГОСТ 23711—79 на ГОСТ 29329—92.

Пункт 5.2.1. Заменить ссылки: ГОСТ 13511—84 на ГОСТ 13511—91, ГОСТ 13514—82 на ГОСТ 13514—93, ГОСТ 15841—77 на ГОСТ 15841—88, ГОСТ 9481—76 на ГОСТ 9481—2001; исключить ссылку: ГОСТ 15629—83.

Пункт 5.3. Заменить ссылку: ГОСТ 9557—73 на ГОСТ 9557—87.

Пункт 5.4. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—77 на ГОСТ 14192—96.

Пункт 5.5. Заменить ссылку и слова: ГОСТ 14192—77 на ГОСТ 14192—96, «Осторожно, хрупкое» на «Хрупкое. Осторожно», «Верх не кантовать» на «Верх».

Приложение. Таблицу дополнить обозначениями бутылок и кодами ОКП:

Условное обозначение бутылки	Код ОКП
БС-МТО-0—250—1в-«М-Б» Бутылка из стекла МТО с гладкой горловиной (типа 2) с одним венчиком с обработанной внутренней поверхностью (группа 2) вместимостью 250 мл	94 6156 0019
БС-МТО-0—450—1в-«М-Б» Бутылка из стекла МТО с гладкой горловиной (типа 2) с одним венчиком с обработанной внутренней поверхностью (группа 2) вместимостью 450 мл	94 6156 0020
БС-МТО-0—450—2в-«М-Б» Бутылка из стекла МТО с гладкой горловиной (типа 2) с двумя венчиками с обработанной внутренней поверхностью (группа 2) вместимостью 450 мл	94 6156 0021

(ИУС № 7 2005 г.)