

Изменение № 1 ГОСТ 10782—85 Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов. Технические условия

Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.09.87 № 3577

Дата введения 01.02.88

Срок введения. Заменить срок введения в части: с 01.01.88 на 01.07.88.

Пункт 1.2. Чертеж 4. Подрисуночная подпись. Заменить значение: 335 на 325;


чертеж 8. Отметки бутылки. Заменить значение: 60 на 50;

чертеж 12 заменить новым:

(Продолжение см. с. 352)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10782—85)

Тип II

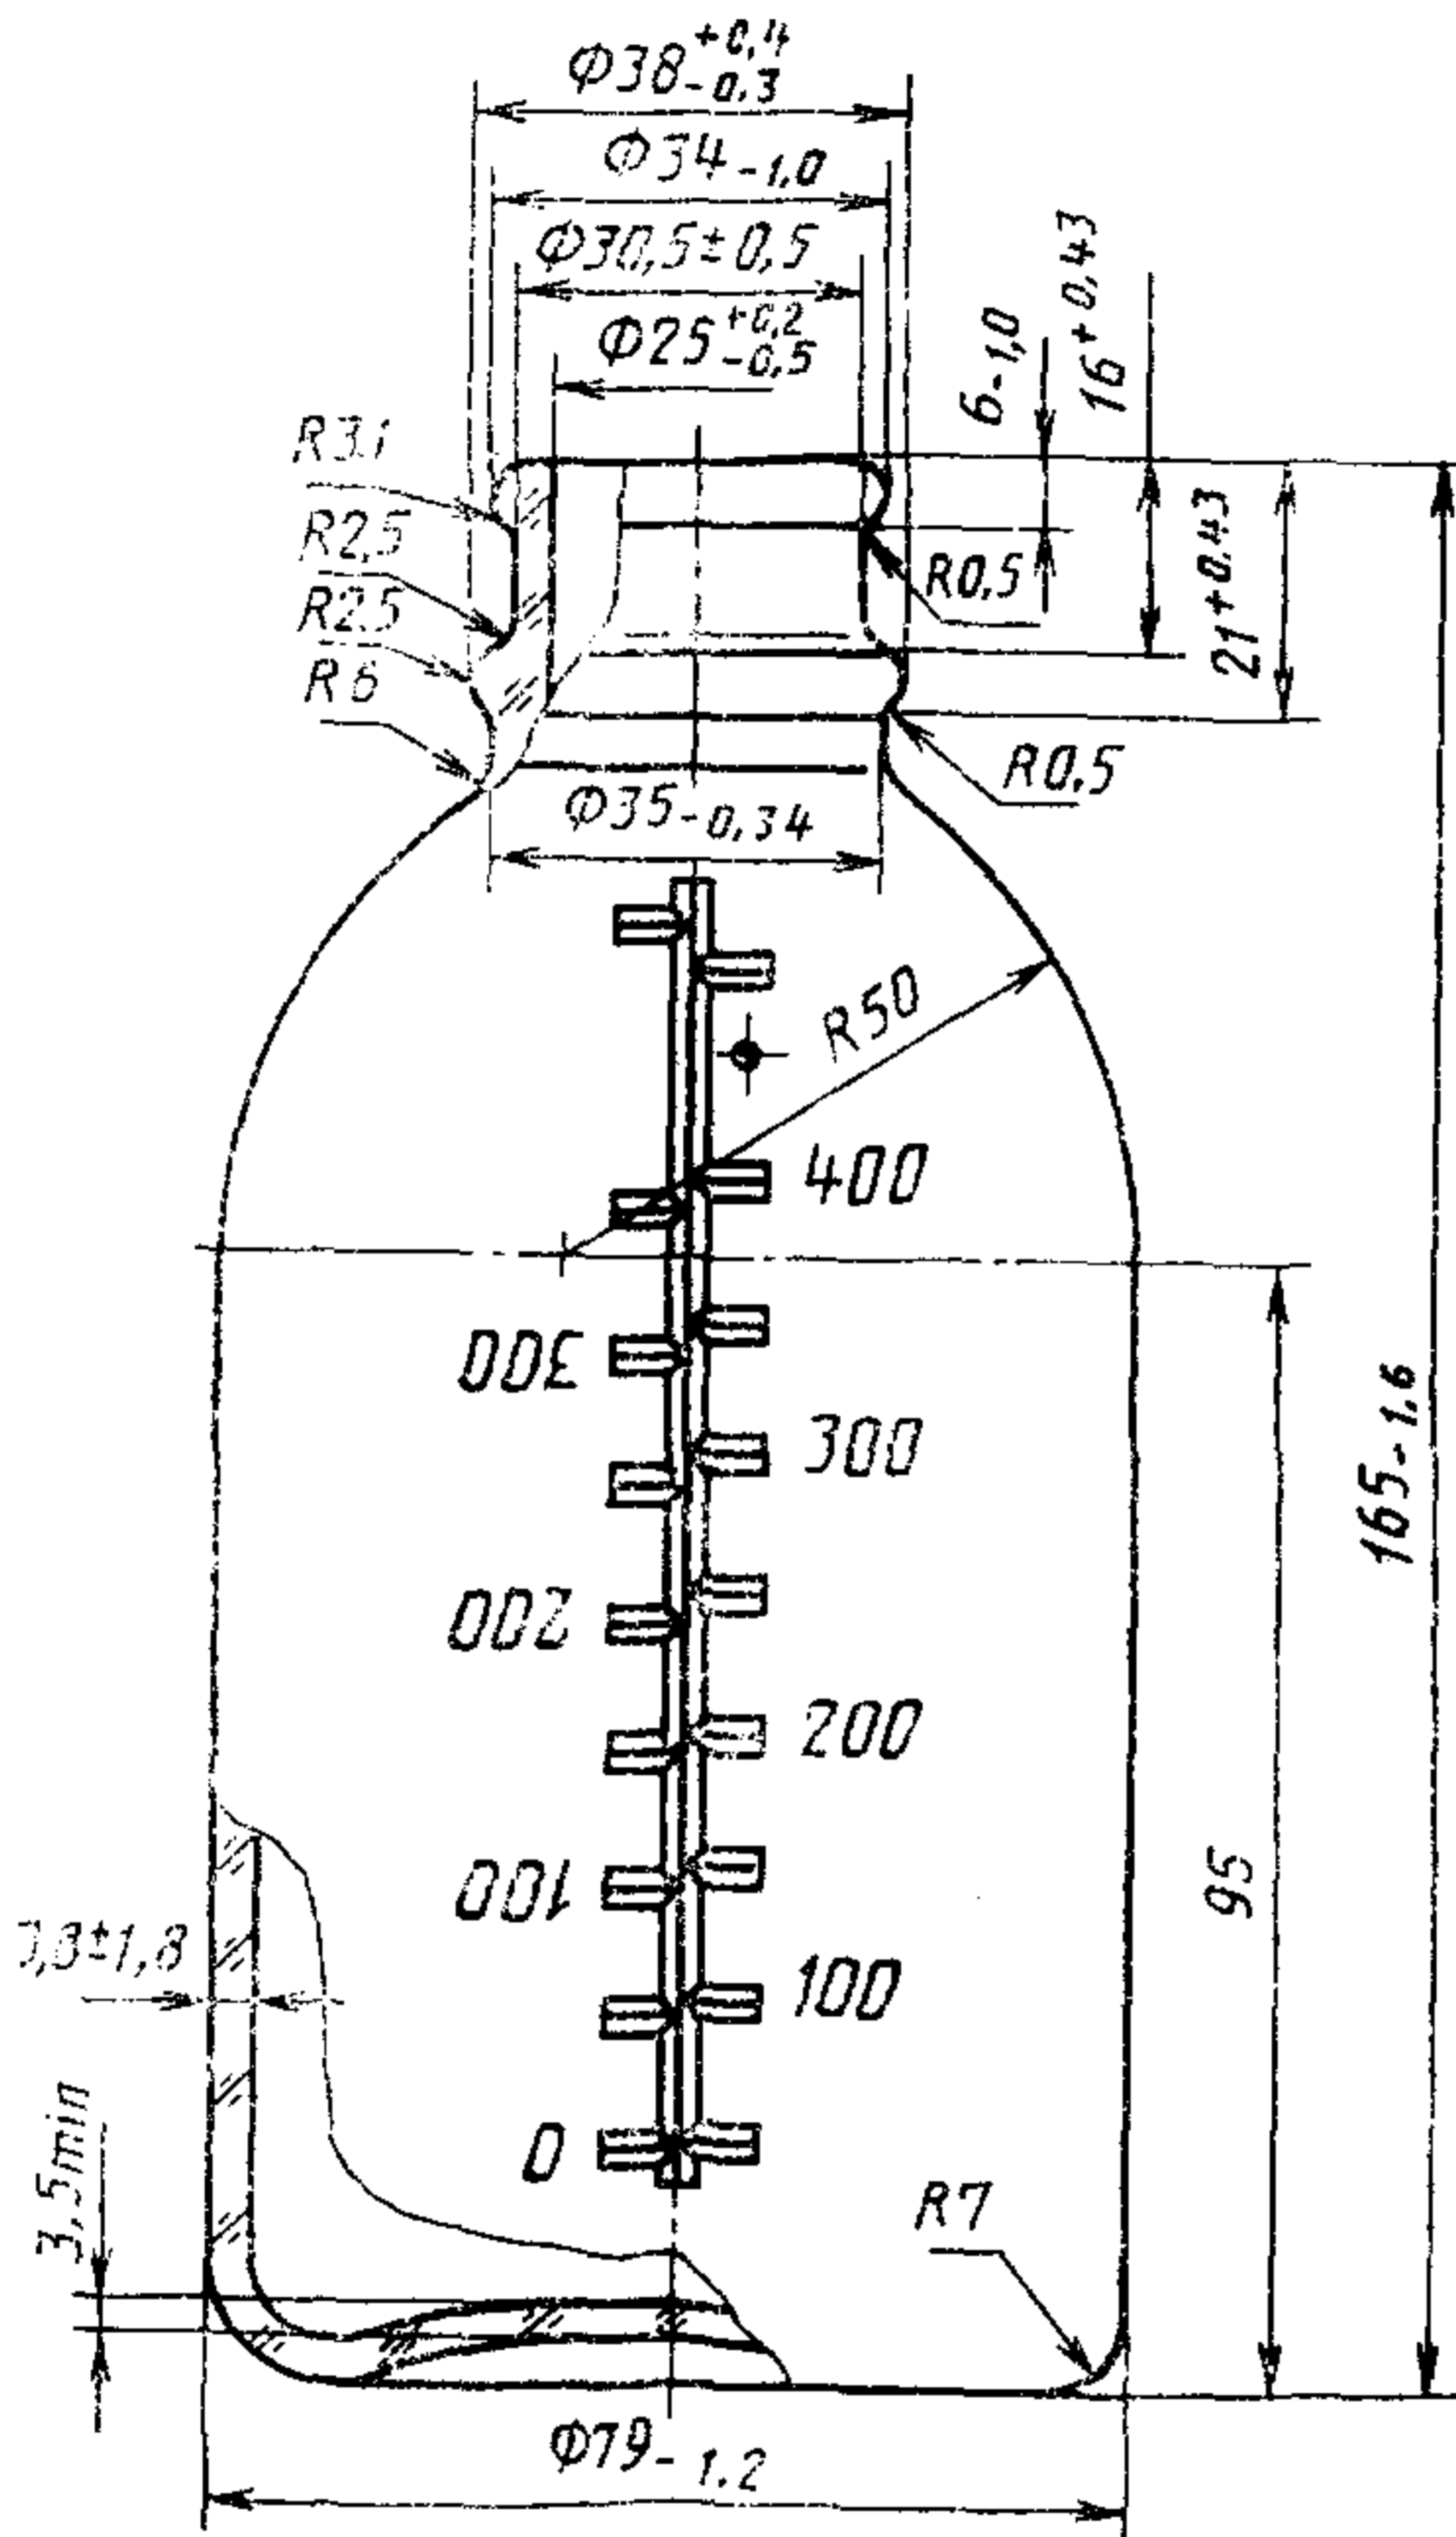

Номинальная вместимость, см^3 — 450.

Полная вместимость, см^3 — 510.

Масса бутылки, г, не более — 335.

Черт. 12

(Продолжение см. с. 353)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10782—85)

Пункт 2.2. Заменить ссылку: ГОСТ 19808—80 на ГОСТ 19808—86.

Пункт 3.1 дополнить абзацем (после третьего): «наименование министерства».

Пункт 3.3. Исключить ссылку: «п. 5.1».

Пункт 3.4. Таблица 4. Пункт 1. Графу «Номера пунктов методов контроля» дополнить ссылкой: 5.1.

Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 19809—74 на ГОСТ 19809—85.

Пункт 4.4.1. Третий абзац. Заменить слово: «точностью» на «погрешностью».

(Продолжение см. с. 354)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10782—85)

Пункт 4.14. Заменить ссылку: ГОСТ 13906—81 на ГОСТ 13903—81.

Пункт 4.18. Заменить ссылку: «п. 2.19» на «п. 2.18».

Пункт 5.1. Заменить слова: «группы I» на «группы 1», «группы II» на «группы 2».

Пункт 5.2.1. Заменить ссылки: ГОСТ 15623—77 на ГОСТ 15623—84, ГОСТ 16511—77 на ГОСТ 16511—86.

Пункт 5.5 дополнить абзацем (после третьего): «наименование министерства».

(ИУС № 12 1987 г.)