


Государственный научный метрологический центр  
ГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии  
им. Д.И. Менделеева"  
(ГНИЦ ГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева")  
Госстандарта России

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГНИЦ ГУП  
"ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"

7 июня 2001 г.

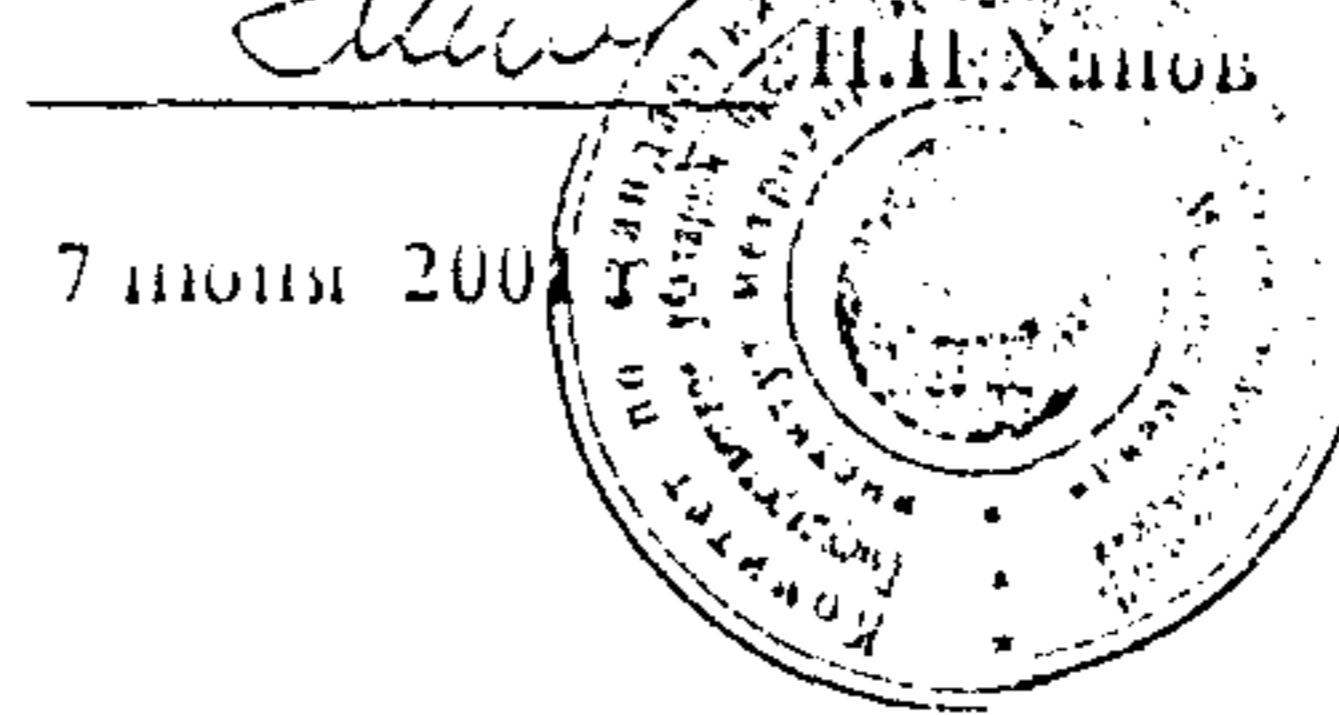

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Государственная система обеспечения единства измерений.  
Порядок применения ГОСТ 1756-52 при измерении давления насыщенных паров  
нефти Харьгинского месторождения компании «TotalFinaElf»

МИ 2668-2001

Санкт-Петербург  
2001 г.

Предисловие

РАЗРАБОТАНА

Государственным научным метрологическим центром ГУП  
«Всероссийский научно-исследовательский институт метроло-  
гии им. Д.И. Менделеева», г. Санкт-Петербург

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Гершун М.А., Конопелько Л.А.

РАЗРАБОТАНА

ООО «Наука II», г. Усинск, Республика Коми

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Амирзянов Р.Ш., Барашкина Т.Б., Нейфельд Н.П.,  
Реброва Н.В.,

УТВЕРЖДЕНА

Государственным научным метрологическим центром ГУП  
«Всероссийский научно-исследовательский институт метроло-  
гии им. Д.И. Менделеева»

4 июня 2001 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

ВНИИМС 7 июня 2001 года

Настоящая рекомендация не может быть полностью и (или) частично воспроиз-  
веденa, тиражированa и распространена без разрешения ГНМЦ ГУП «ВНИИМ  
им. Д.И.Менделеева» и ООО «Наука II»

## Содержание

	Стр.
1. Область применения	4
2. Нормативные ссылки	4
3. Метод измерений давления насыщенных паров	4
Приложение А. Физико-химические показатели нефти Харыгинского месторождения компании «Total- FinaElf»	6
Приложение Б. Зависимость падения давления насы- щенных паров нефти от температуры заполнения топ- ливной камеры	7
Приложение В. Устройство пробоотборной посуды	8

## РЕКОМЕНДАЦИЯ

Государственная система обеспечения единства измерений Порядок применения ГОСТ 1756-52 при измерении давления насыщенных паров нефти Харьгинского месторождения компании «TotalFinaElf»	МИ 2668-2001
--	--------------

Срок введения в действие: 01.07.2001 г.

### 1. Область применения

Настоящая рекомендация распространяется на метод определения давления насыщенных паров нефти (после высокотемпературной термической обработки) Харьгинского месторождения компании «TotalFinaElf».

Физико-химические показатели нефти приведены в приложении А.

Результаты экспериментальных исследований зависимости измеряемого давления насыщенных паров от температуры нефти в момент заполнения топливной камеры (приложение Б) показали, что при заполнении топливной камеры бомбы Рейда при температуре ниже 20 °C измеряемое значение давления насыщенных паров значимо не отличается от измеряемого значения при заполнении топливной камеры при температуре 15 °C. Это подтверждает отсутствие потерь легких фракций при температуре ниже 20 °C и, следовательно, возможность достоверных измерений давления насыщенных паров при температуре нефти в момент заполнения топливной камеры 18 °C и ниже.

Измерения давления насыщенных паров выполняют в соответствии с ГОСТ 1756-52 (метод А) при охлаждении образца и топливной камеры до температуры в диапазоне 15 ... 18 °C вследствие высокой температуры застывания нефти (12 ... 14 °C).

### 2. Нормативные ссылки

В настоящей рекомендации использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 1756-52 «Нефтепродукты. Методы определения давления насыщенных паров»,

ГОСТ 2517-85 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб».

### 3. Метод измерения давления насыщенных паров

Отбор проб нефти проводят по ГОСТ 2517-85 непосредственно на объекте в специальную пробоотборочную посуду вместимостью не менее 1 дм<sup>3</sup> и не более 8 дм<sup>3</sup> (приложение В) через медную трубку (3) и плотно закрывают пластмассовыми пробками трубы (2, 3).

Посуда снабжена специальным переливающим устройством и обеспечивает герметичность отобранный пробы. Посуду с пробкой в специальной таре доставляют в лабораторию.

В лабораторных условиях посуду помещают в терmostатированную баню (термостат с погрешностью регулирования температуры не более 0,1 °C) на время не менее 120 мин. При достижении температуры от 15 до 18 °C посуду с пробой вынимают из бани и проверяют объем пробы, который должен составлять от 70 до 80 % объема посуды.

В целях обеспечения равновесного состояния исследуемого образца нефти с воздухом посуду с пробой тщательно встряхивают и помещают в охлаждающую баню.

Берут топливную камеру бомбы, неплотно закрывают пластмассовой пробкой, вставляют термометр (цена деления 0,1 °C) и, погрузив в терmostатированную баню, выдерживают до достижения показания термометра от 15 до 18 °C.

Подготовку воздушной камеры проводят по ГОСТ 1756-52 (пп. 19.2, 19.3).

Охлажденную пробоотборную посуду с пробой и топливную камеру вынимают из терmostатированной бани, в течение 10 ... 15 с переворачивают охлажденную топливную камеру и надевают ее сверху на трубку посуды для слива нефти. Переворачивают всю систему таким образом, чтобы топливная камера приняла строго вертикальное положение отверстием вверх и трубка посуды для слива нефти была погружена в топливную камеру.

Длина трубы рассчитана на погружение до 6 мм от дна камеры.

Топливную камеру заполняют нефтью по ГОСТ 1756-52. При необходимости нефть доливают до тех пор, пока она не начнет переливаться через верхний край камеры.

Измерения давления насыщенных паров проводят по ГОСТ 1756-52 (пп. 19.4.6, 20.2, 20.3, 20.4, 20.6).


Обработку результатов измерений проводят по ГОСТ 1756-52 (пп. 21.1, 21.2).

Погрешность метода определяют по ГОСТ 1756-52 (п. 21.3).

**Физико-химические показатели нефти  
Харьгинского месторождения компании «TotalFinaElf»**


№ п/п	Контролируемый показа- тель	Единица величины	Диапазон измеряемых параметров	НД на методы испытаний
1	Содержание воды	%	Не более 0,5	ГОСТ 2477-65
2	Плотность при 20 °C	кг/м <sup>3</sup>	825,0 ... 828,4	ГОСТ 3900-85
3	Содержание мех. примесей (мас. доля)	%	Не более 0,05	ГОСТ 6370-83
4	Кинематическая вязкость при 35 °C	сСт	7,0 ... 11,0	ГОСТ 33-82
5	Содержание хлористых со- лей	мг/дм <sup>3</sup>	Не более 100,0	ГОСТ 21534-76
6	Содержание асфальтенов	%	0,65 ... 1,30	ГОСТ 11858-66
7	Содержание смол	%	6,2 ... 9,7	ГОСТ 11858-66
8	Содержание парафинов	%	9,3 ... 19	ГОСТ 11851-85
9	Содержание серы	%	0,21 ... 0,30	ГОСТ 1437-75
10	Температура застывания	°C	+12 ... +14	ГОСТ 20287-74

Зависимость падения измеряемого давления  
насыщенных паров нефти от температуры нефти в  
момент заполнения топливной камеры

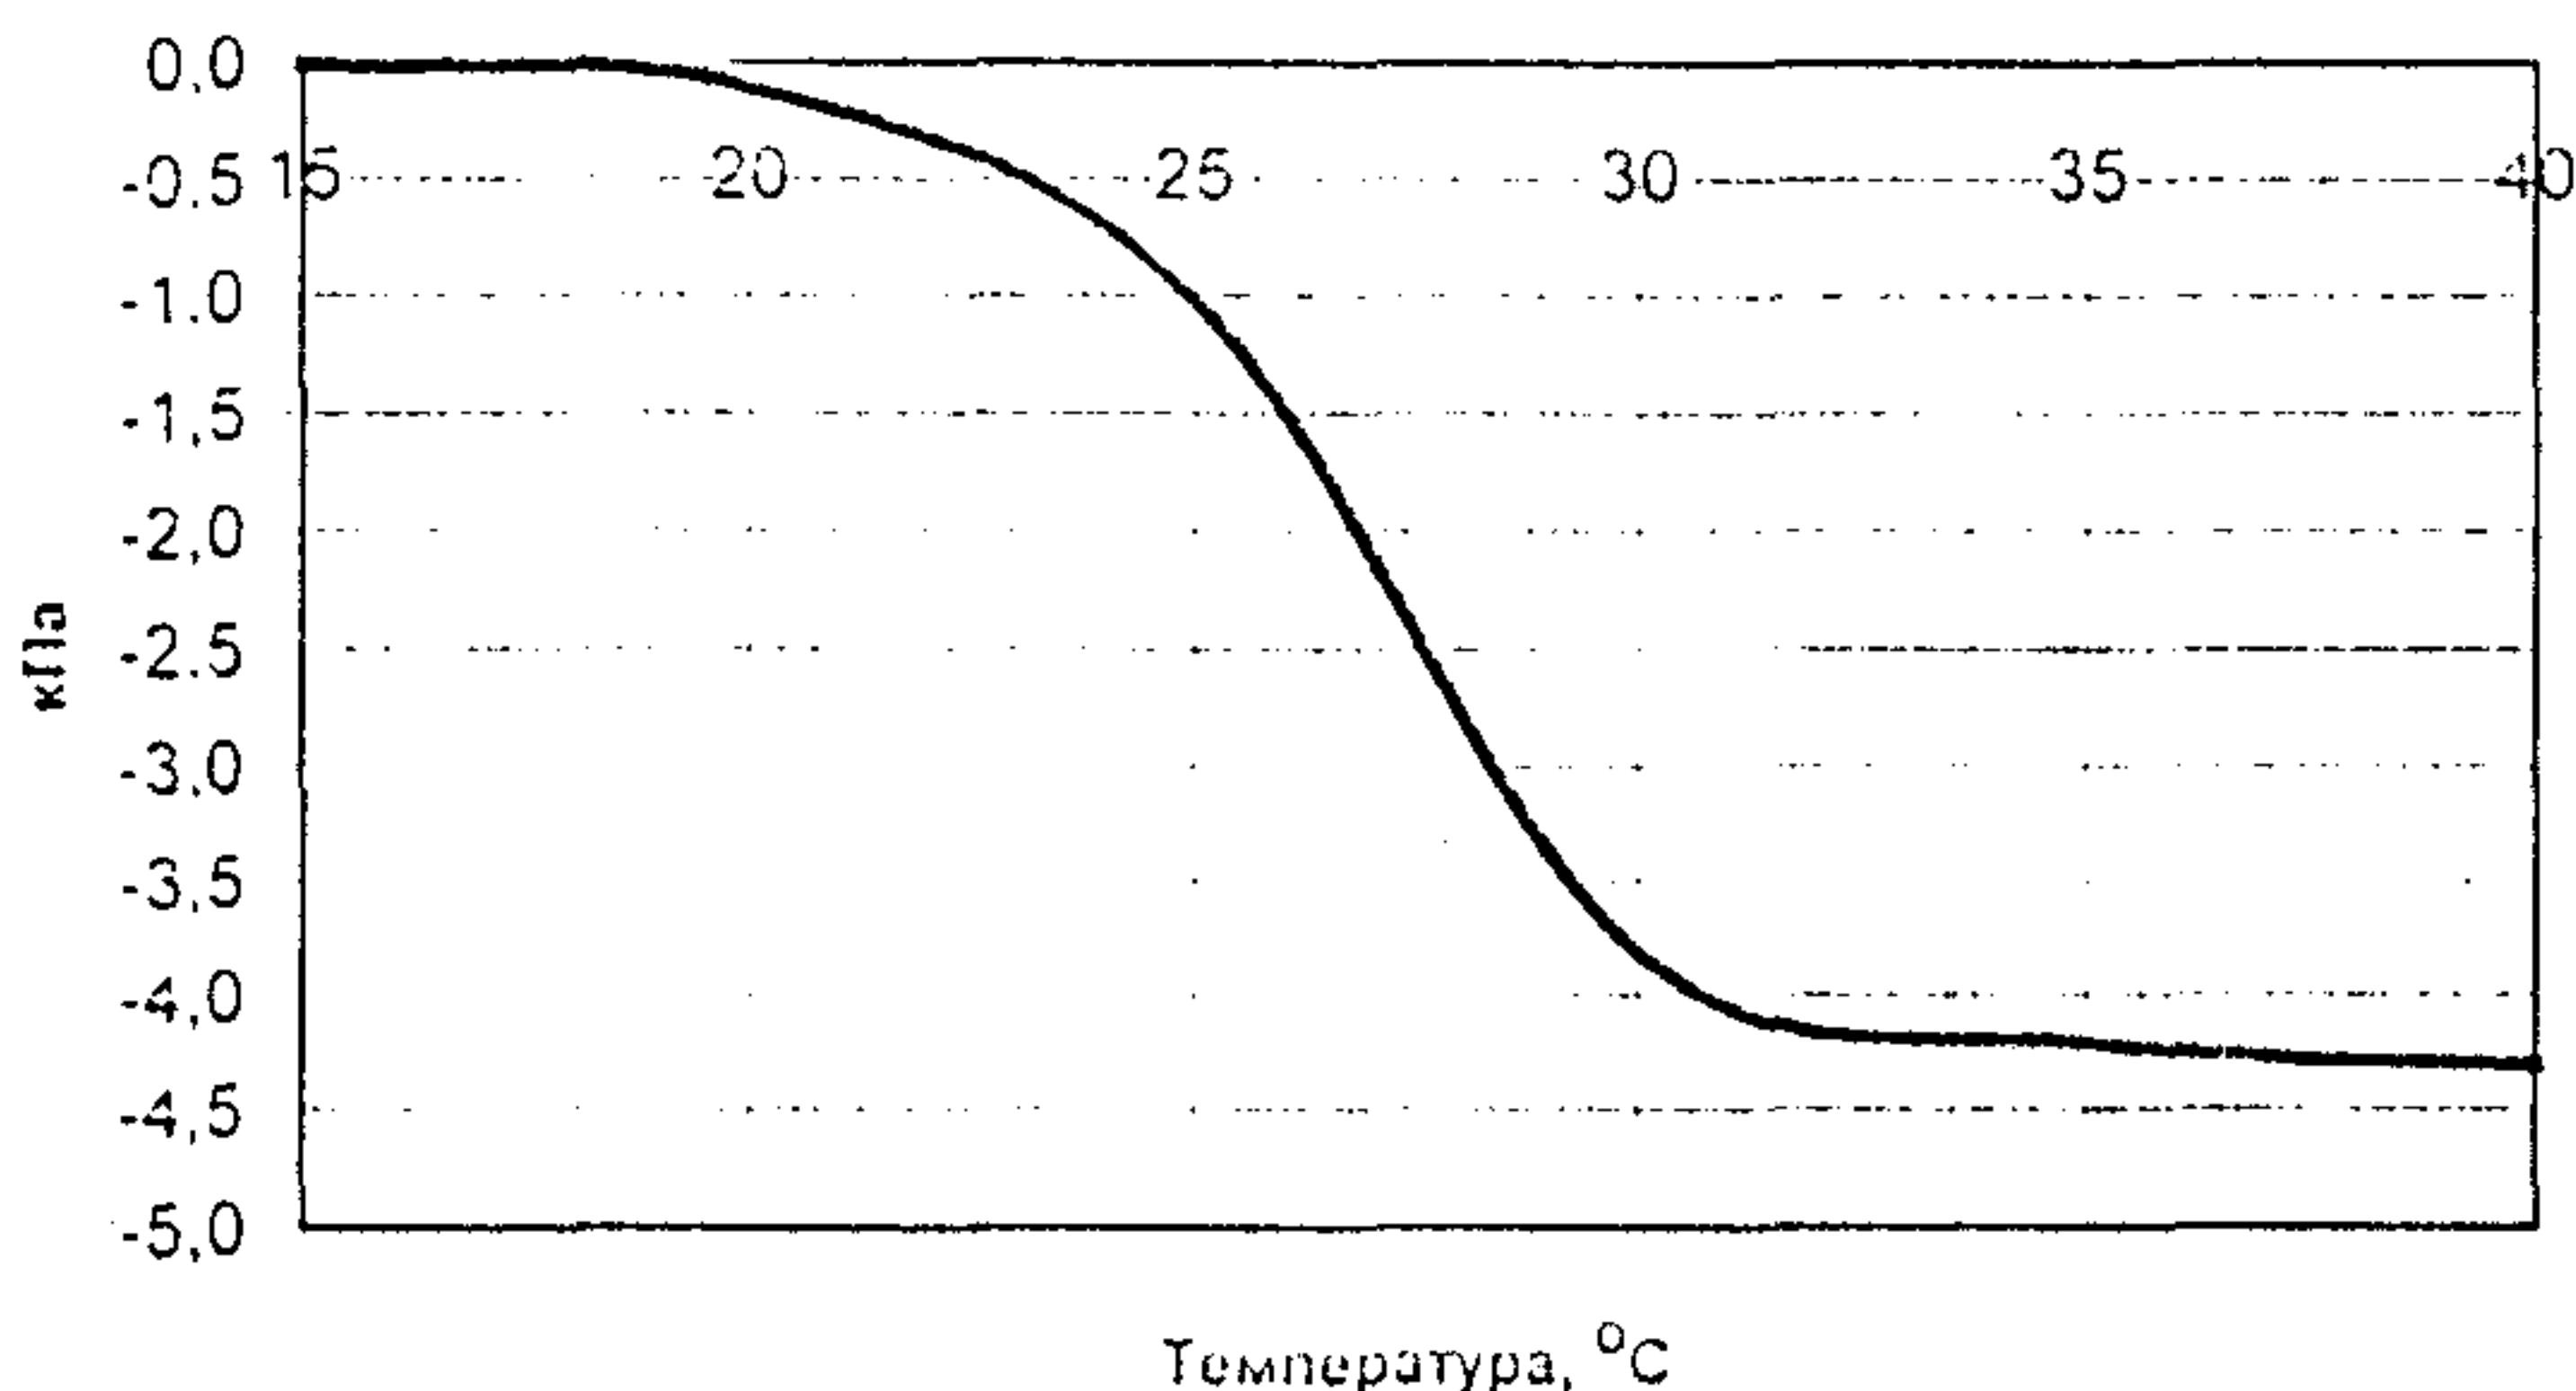

## Приложение В

Пробоотборная посуда для нефти с переливающим устройством.

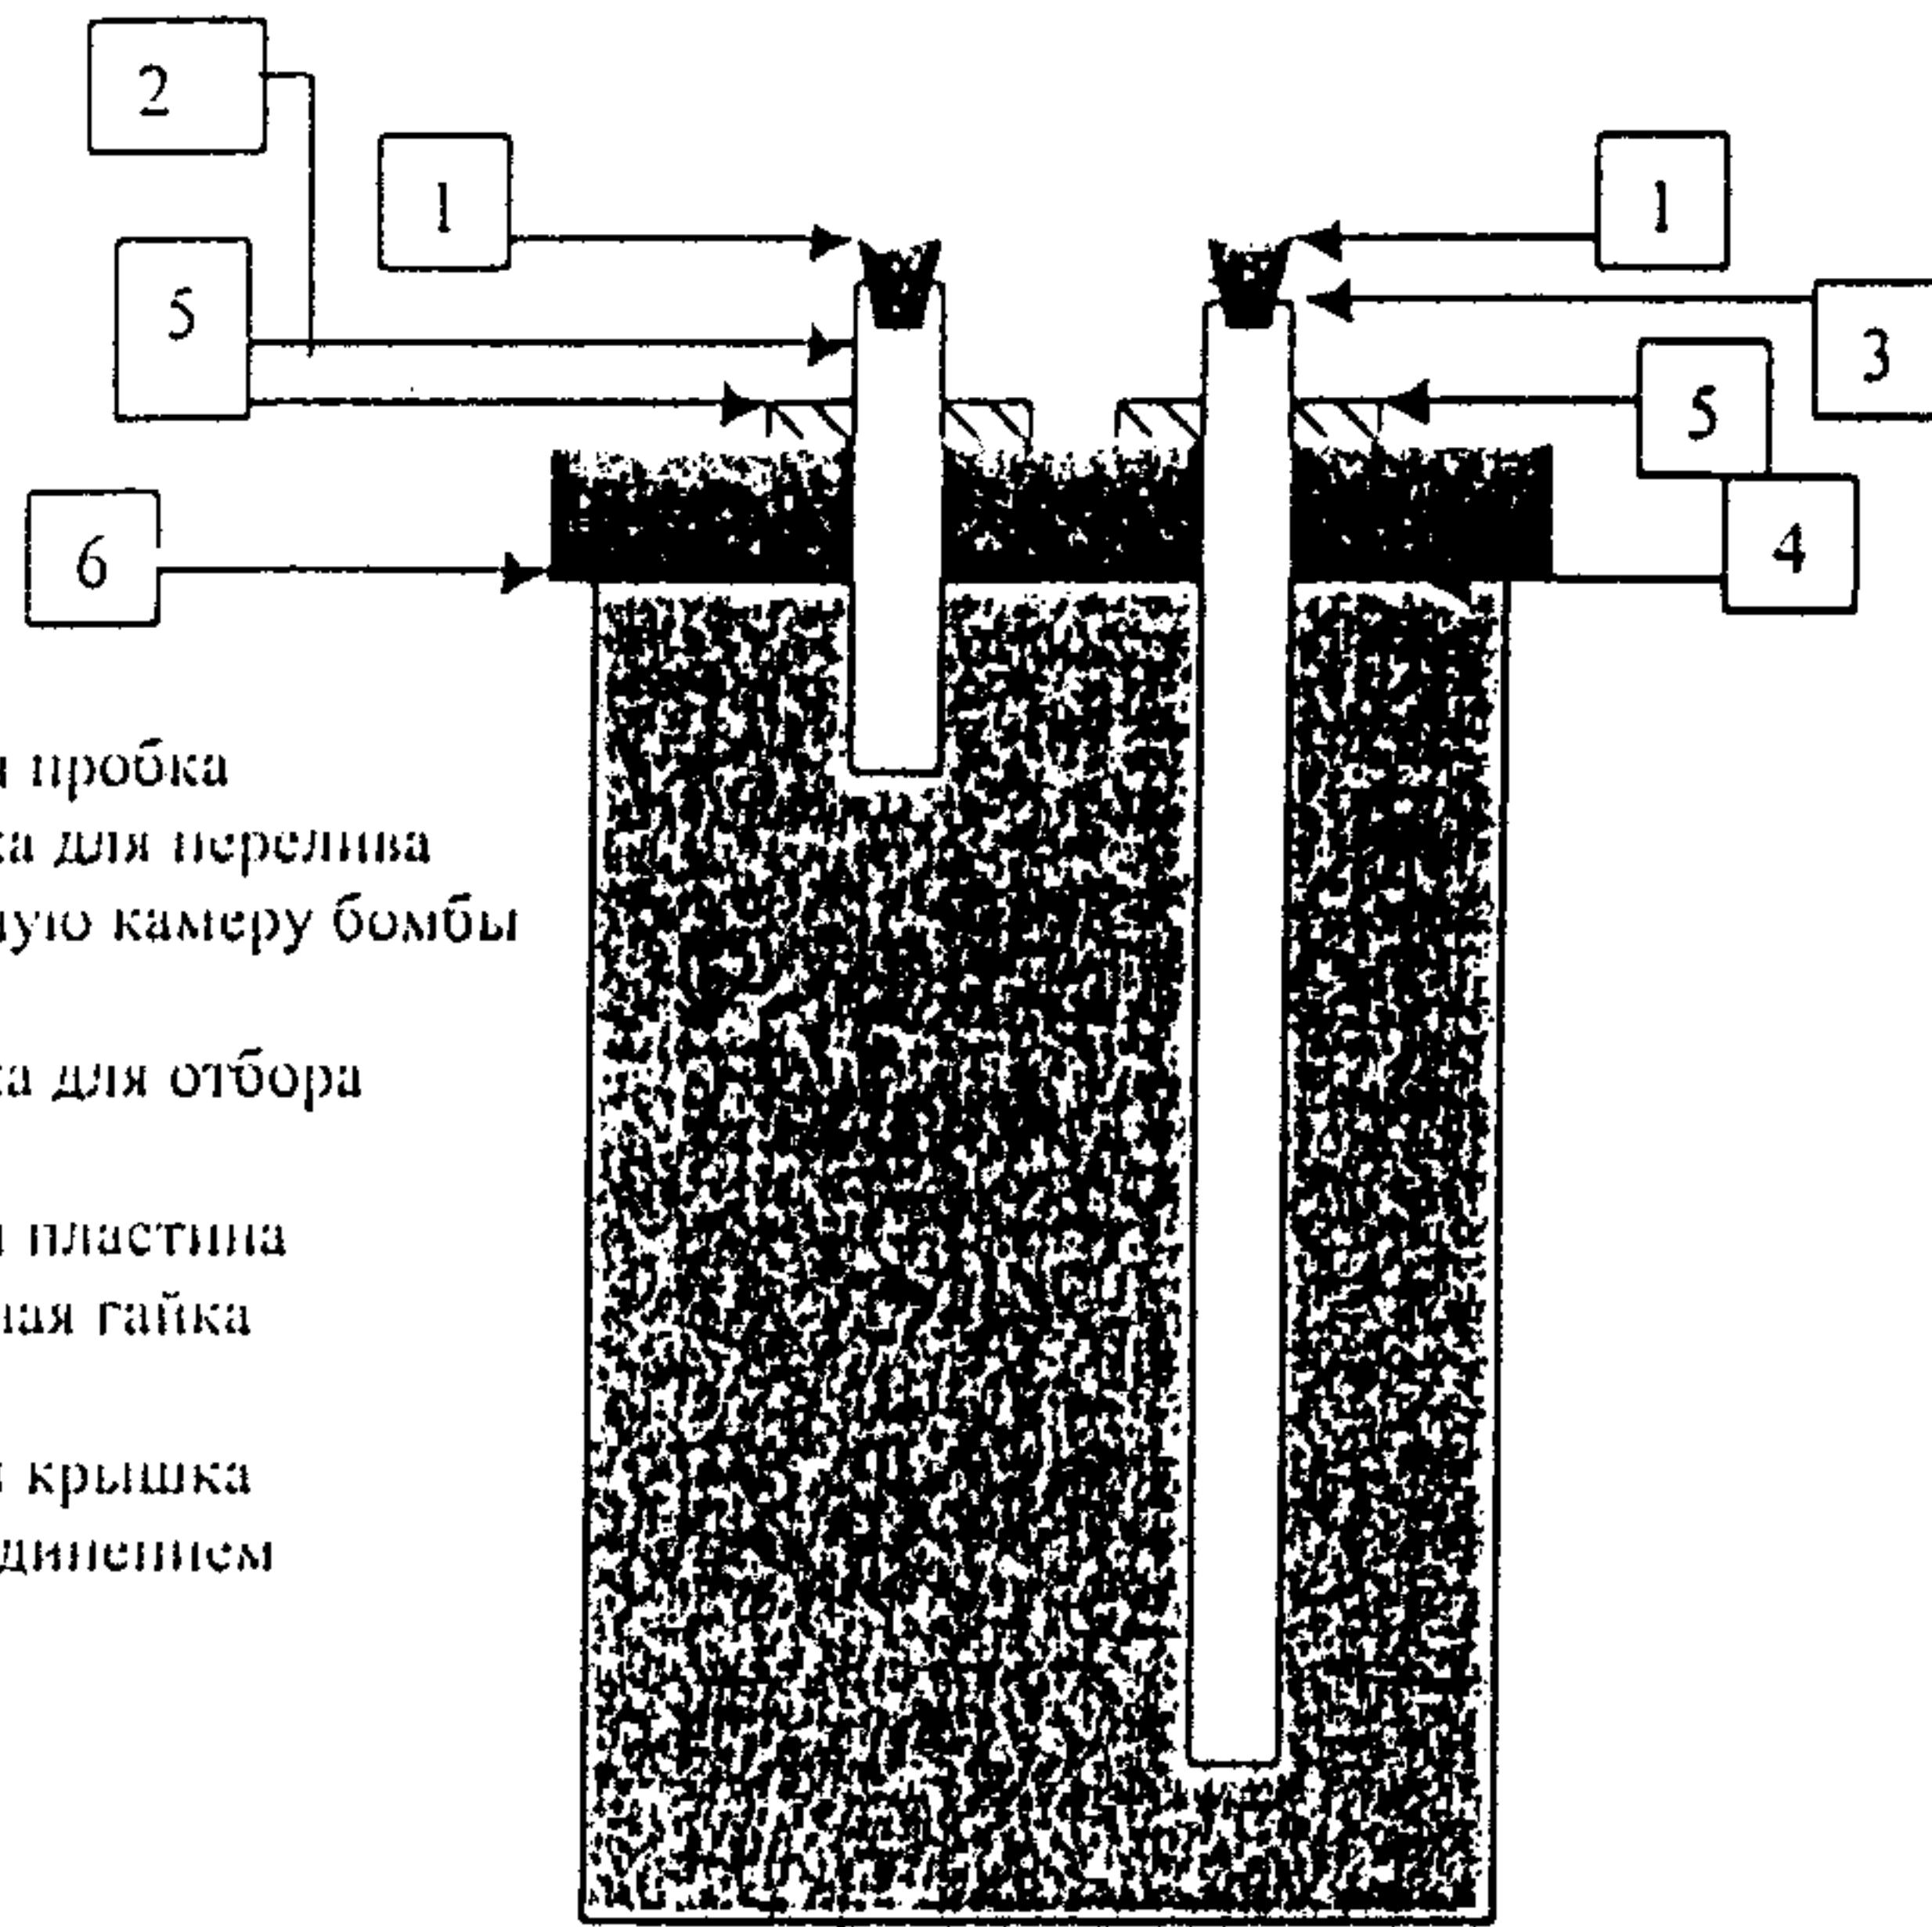

- 1 - пластмасовая пробка
- 2 - медная трубка для перелива нефти в топливную камеру бомбы Рейда
- 3 - медная трубка для отбора пробы нефти
- 4 - металлическая пластина
- 5 - уплотнительная гайка с прокладкой
- 6 - металлическая крышка с резьбовым соединением