


---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---

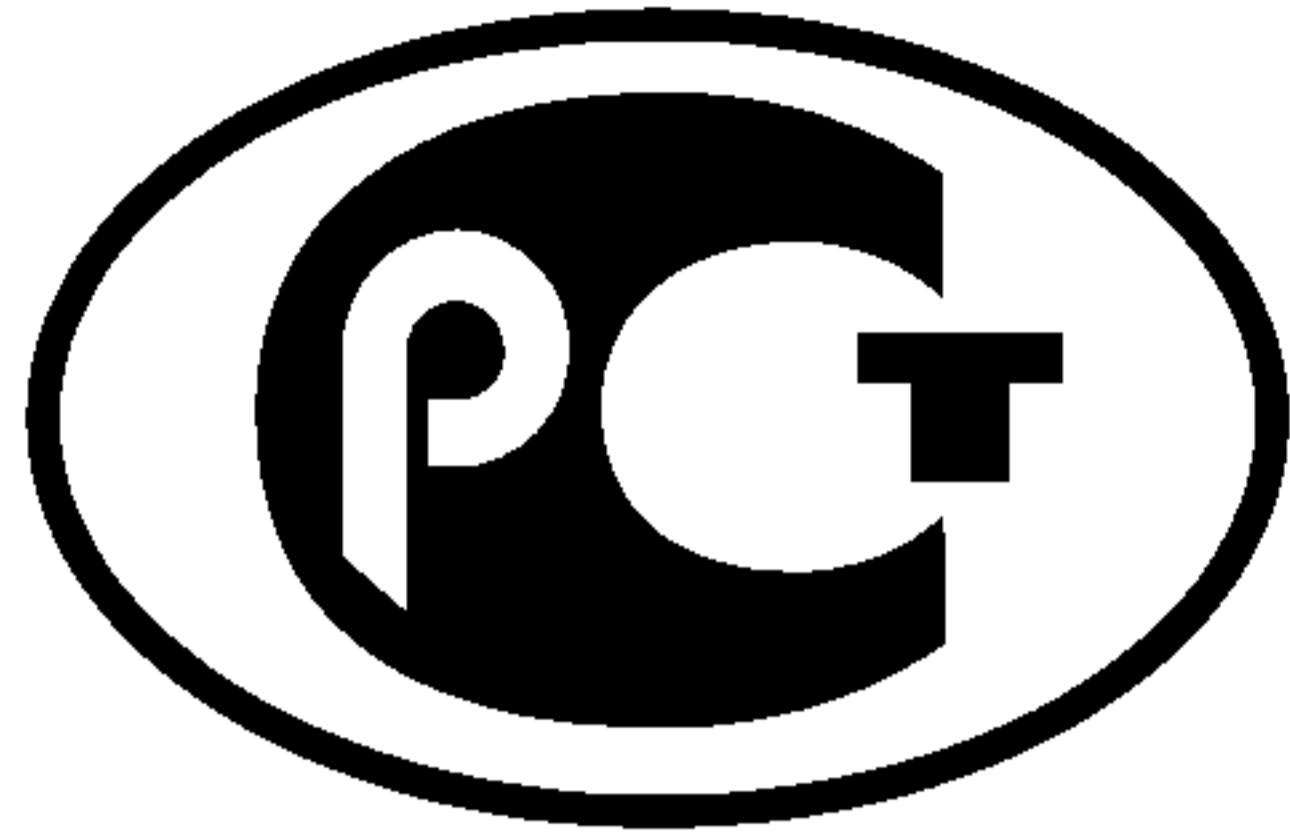

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
53126—  
2008

---

МЕД

**Рефрактометрический метод определения воды**

Издание официальное

531—2009/570



Москва  
Стандартинформ  
2009

## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Государственным научным учреждением Научно-исследовательским институтом пчеловодства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ НИИП Россельхозакадемии) и Обществом с ограниченной ответственностью «Аналитический центр Апис»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 432 «Пчеловодство»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 г. № 546-ст

4 ВВЕДЕН В ПЕРВЫЕ

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

© Стандартинформ, 2009

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

|  |   |
|--|---|
| 1 Область применения . . . . .                               | 1 |
| 2 Нормативные ссылки . . . . .                               | 1 |
| 3 Термины и определения . . . . .                            | 2 |
| 4 Отбор проб . . . . .                                       | 2 |
| 5 Подготовка к выполнению измерений . . . . .                | 2 |
| 6 Средства измерений, вспомогательное оборудование . . . . . | 2 |
| 7 Проведение измерения . . . . .                             | 2 |
| 8 Представление результатов испытаний . . . . .              | 3 |
| 9 Характеристика погрешности измерений . . . . .             | 4 |
| Библиография . . . . .                                       | 4 |

МЕД

Рефрактометрический метод определения воды

Honey. Refractometric method for determination of water

Дата введения — 2010—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на мед и устанавливает рефрактометрический метод определения массовой доли воды в нем.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО 5725-1—2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения

ГОСТ Р ИСО 5725-6—2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025—2006 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

ГОСТ Р 51568—99 (ИСО 3310-1—90) Сита лабораторные из металлической проволочной сетки

ГОСТ Р 52001—2002 Пчеловодство. Термины и определения

ГОСТ 14919—83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 19792—2001 Мед натуральный. Технические условия

ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 28498—90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте приведены термины по ГОСТ Р 52001, ГОСТ Р ИСО 5725-1.

### 4 Отбор проб

Отбор проб — по ГОСТ 19792.

### 5 Подготовка к выполнению измерений

#### 5.1 Подготовка пробы меда к испытанию

5.1.1 Для проведения измерений используют незакристаллизованный мед. Закристаллизованный мед предварительно размягчают на водяной бане по 6.2 или в сушильном шкафу по 6.3 при температуре не выше 40 °С и продавливают через сито по 6.6 шпателем по 6.7.

5.1.2 Сотовый мед распечатывают, отделяют от сот при помощи металлического сита без нагревания.

Анализируемую пробу меда тщательно перемешивают не менее 3 мин. При перемешивании обращают внимание на то, чтобы в мед попало меньше воздуха.

5.1.3 Мед с примесями после растворения кристаллов процеживают при комнатной температуре через сито.

5.1.4 Около 3 см<sup>3</sup> меда помещают в стеклянную пробирку по 6.4, плотно закрывают резиновой пробкой и выдерживают на водяной бане при температуре (60,0 ± 0,2) °С до полного растворения кристаллов. Затем пробирку вынимают из водяной бани и охлаждают до комнатной температуры, не открывая пробирку. Воду, сконденсировавшуюся на внутренней поверхности стенок пробирки, тщательно перемешивают с медом.

5.2 Проверку и регулировку рефрактометра по 6.1 проводят в соответствии с инструкцией к прибору. Контроль юстировки проводят по дистиллированной воде при одной из температур в интервале от 18 °С до 22 °С перед каждым определением массовой доли воды.

### 6 Средства измерений, вспомогательное оборудование

6.1 ИРФ-454 по [1] с пределом допускаемой основной погрешности рефрактометра по показателю преломления  $\pm 1 \cdot 10^{-4}$ .

6.2 Баня водяная лабораторная с электрическим или огневым подогревом по [2].

6.3 Сушильный шкаф по ГОСТ 14919.

6.4 Пробирки стеклянные П 1-7-40 по ГОСТ 25336.

6.5 Термометр ртутный стеклянный лабораторный до 100 °С с ценой деления 1 °С по ГОСТ 28498.

6.6 Сито лабораторное из металлической сетки, диаметр отверстий 0,5 мм по ГОСТ Р 51568.

6.7 Шпатель лабораторный по [3].

Допускается применение средств измерений и вспомогательного оборудования с аналогичными метрологическими и техническими характеристиками.

### 7 Проведение измерения

7.1 На чистую и сухую поверхность измерительной рефрактометрической призмы осторожно, не касаясь призмы, наносят ровный слой меда, подготовленного по 5.1.4, опускают осветительную призму и прижимают ее. Через 2 мин определяют показатель преломления. Отмечают температуру по 6.5, при которой проводят измерение. Для каждого образца меда делают не менее двух измерений показателя преломления.

7.2 По показателю преломления определяют массовую долю воды в меде по таблице 1.

Т а б л и ц а 1 — Зависимость массовой доли воды в меди от показателя преломления

| Показатель преломления $n_D^{20}$ | Массовая доля воды $W$ , % | Показатель преломления $n_D^{20}$ | Массовая доля воды $W$ , % | Показатель преломления $n_D^{20}$ | Массовая доля воды $W$ , % |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1,5044                            | 13,0                       | 1,4935                            | 17,2                       | 1,4830                            | 21,4                       |
| 1,5038                            | 13,2                       | 1,4930                            | 17,4                       | 1,4825                            | 21,6                       |
| 1,5033                            | 13,4                       | 1,4925                            | 17,6                       | 1,4820                            | 21,8                       |
| 1,5028                            | 13,6                       | 1,4920                            | 17,8                       | 1,4815                            | 22,0                       |
| 1,5023                            | 13,8                       | 1,4915                            | 18,0                       | 1,4810                            | 22,2                       |
| 1,5018                            | 14,0                       | 1,4910                            | 18,2                       | 1,4805                            | 22,4                       |
| 1,5012                            | 14,2                       | 1,4905                            | 18,4                       | 1,4800                            | 22,6                       |
| 1,5007                            | 14,4                       | 1,4900                            | 18,6                       | 1,4795                            | 22,8                       |
| 1,5002                            | 14,6                       | 1,4895                            | 18,8                       | 1,4790                            | 23,0                       |
| 1,4997                            | 14,8                       | 1,4890                            | 19,0                       | 1,4785                            | 23,2                       |
| 1,4992                            | 15,0                       | 1,4885                            | 19,2                       | 1,4780                            | 23,4                       |
| 1,4987                            | 15,2                       | 1,4880                            | 19,4                       | 1,4775                            | 23,6                       |
| 1,4982                            | 15,4                       | 1,4875                            | 19,6                       | 1,4770                            | 23,8                       |
| 1,4976                            | 15,6                       | 1,4870                            | 19,8                       | 1,4765                            | 24,0                       |
| 1,4971                            | 15,8                       | 1,4865                            | 20,0                       | 1,4760                            | 24,2                       |
| 1,4966                            | 16,0                       | 1,4860                            | 20,2                       | 1,4755                            | 24,4                       |
| 1,4961                            | 16,2                       | 1,4855                            | 20,4                       | 1,4750                            | 24,6                       |
| 1,4956                            | 16,4                       | 1,4850                            | 20,6                       | 1,4745                            | 24,8                       |
| 1,4950                            | 16,6                       | 1,4845                            | 20,8                       | 1,4740                            | 25,0                       |
| 1,4946                            | 16,8                       | 1,4840                            | 21,0                       |                                   |                            |
| 1,4940                            | 17,0                       | 1,4835                            | 21,2                       |                                   |                            |

П р и м е ч а н и е —  $n_D^{20}$  — значение показателя преломления при температуре 20 °С.

Если определения проводят при температуре ниже или выше 20 °С, то вводят поправку на каждый градус Цельсия: для температур выше 20 °С прибавляют к показателю преломления 0,00023; для температур ниже 20 °С вычитают из показателя преломления 0,00023.

## 8 Представление результатов испытаний

Статистический анализ результатов измерений по оценке точности метода проводят в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 5725-1 и ГОСТ Р ИСО 5725-6.

8.1 За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение двух параллельных измерений, полученных в условиях повторяемости (одна и та же методика, идентичный объект испытания, одна и та же лаборатория, один и тот же оператор, одно и тоже оборудование, короткий промежуток времени), если расхождение между ними не превышает абсолютного предела повторяемости  $r$ . Значение предела повторяемости  $r$  представлено в таблице 2.

При превышении предела повторяемости  $r$  проводят повторные измерения и проверку приемлемости результатов измерений, полученных в условиях повторяемости в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-6 (пункт 5.2.2).

8.2 Расхождение между результатами двух независимых измерений, полученных в условиях воспроизводимости (одна и та же методика, идентичный объект испытания, разные лаборатории, различное оборудование), не должно превышать предела воспроизводимости  $R$ . Значение предела воспроизводимости  $R$  приведено в таблице 2.

Т а б л и ц а 2 — Диапазон измерений, значения характеристик погрешности и ее составляющих при доверительной вероятности  $P = 0,95$ 

| Диапазон значений массовой доли воды $W$ , % | Предел повторяемости (двух результатов параллельных определений) $r$ , % | Предел воспроизводимости (значение допускаемого расхождения между двумя результатами измерений, полученными в разных лабораториях) $R$ , % | Погрешность $\pm \Delta$ при $P = 0,95$ , не более |
|--|--|--|--|
| От 13,0 до 25,0 включ.                       | 0,03 $\bar{W}$   | 0,06 $\bar{W}$   | 0,04 $\bar{W}$                                     |

### 8.3 Форма представления результатов

Результат измерения представляют в виде значения, округленного до десятичной доли, в диапазоне значений массовой доли воды от 13,0 % до 25,0 % включительно.

## 9 Характеристика погрешности измерений

9.1 Погрешность результатов испытаний  $\pm \Delta$ , полученных согласно данному методу, при доверительной вероятности  $P = 0,95$ , приведена в таблице 2.

9.2 Результаты испытаний оформляют протоколом в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025.

## Библиография

- [1] ТУ 3-3.ЭД1.1531—80 Рефрактометр ИРФ-454
- [2] ТУ 64-1.2850—80 Баня водяная лабораторная с электрическим или огневым подогревом
- [3] ТУ 10-23-72—88 Шпатель лабораторный ШЛ

---

УДК 638.16:006.354

C52

OKC 67.180.10

Ключевые слова: мед, вода, рефрактометрический метод, показатель преломления, метрологические характеристики

---

Редактор *Л.В. Коротникова*  
Технический редактор *Н.С. Гришанова*  
Корректор *В.Е. Нестерова*  
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 14.07.2009. Подписано в печать 11.08.2009. Формат 60 × 84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,55. Тираж 253 экз. Зак. 521.

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.

[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.