

УДК 003.62(084):66.05

Группа Т52

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00004-88

АГРЕГАТЫ  
КИСЛОРОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
Обозначения условные графические

На 5 страницах

ОКСТУ 7557

Дата введения 01.07.89

Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения агрегатов кислородного оборудования в принципиальных схемах.

№ изм.

№ изд.

Инв. № дубликата

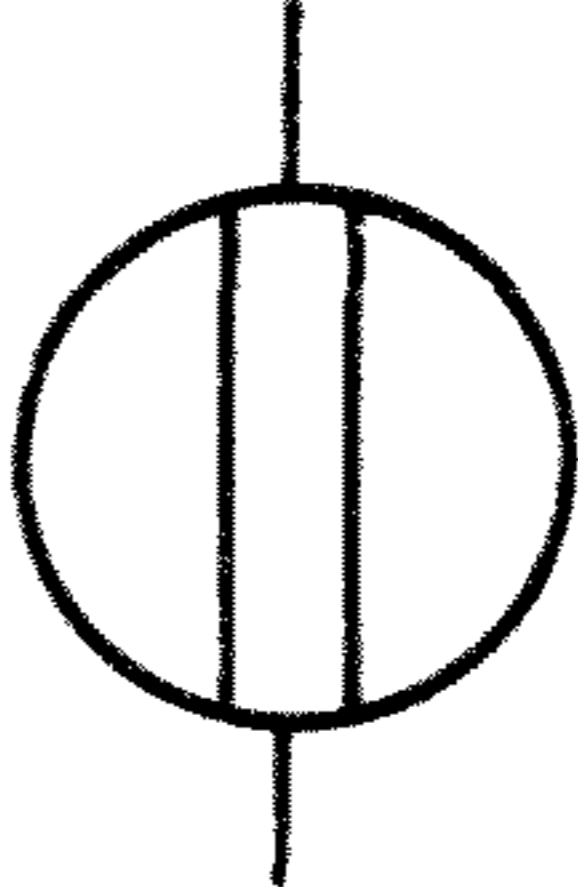
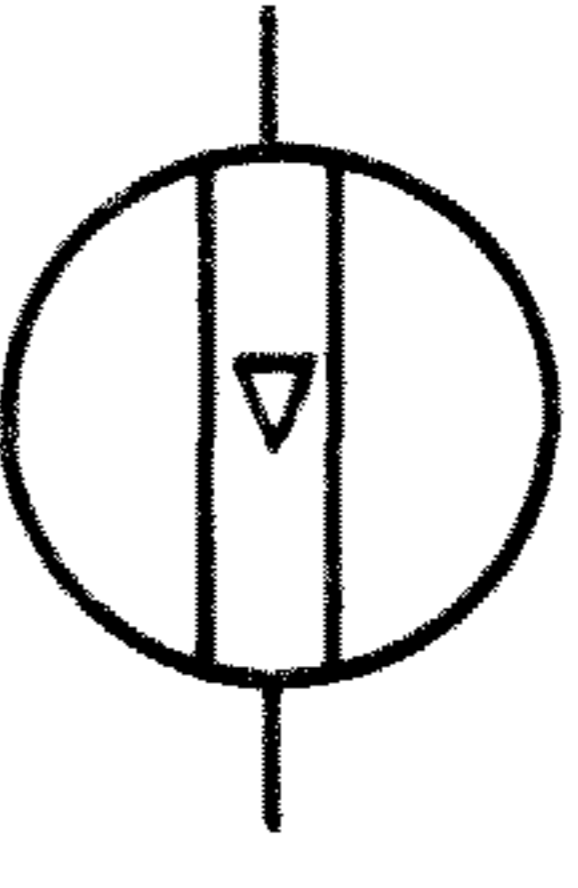
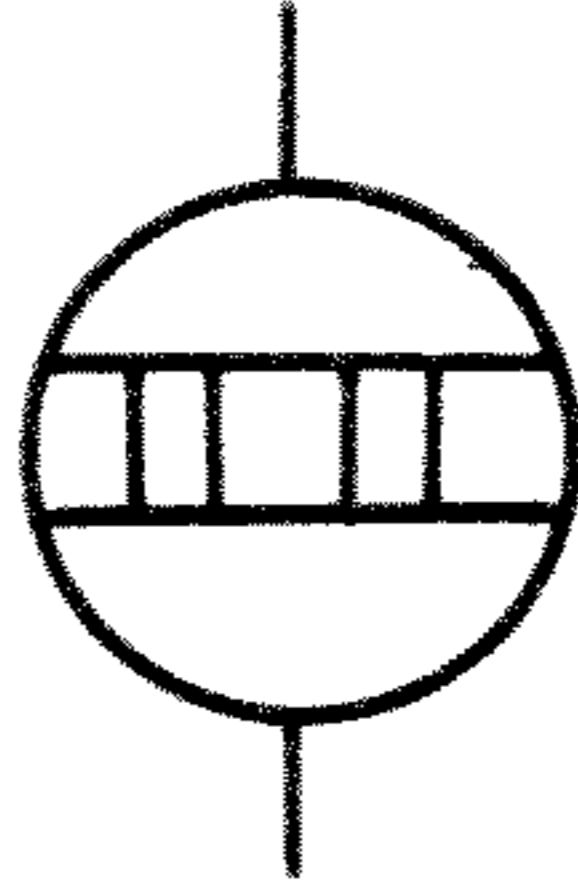
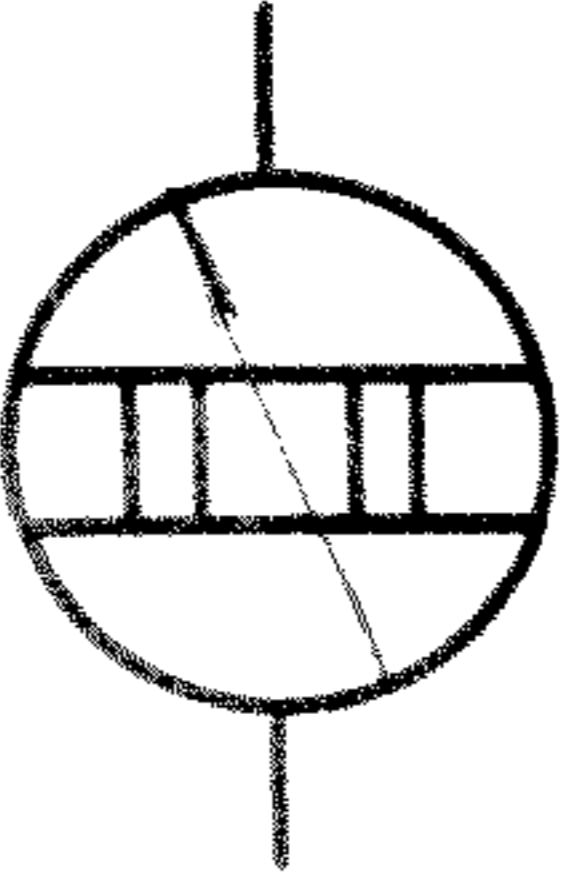
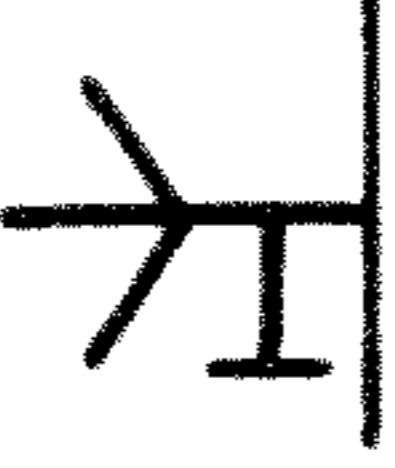

Инв. № подлинника

5772

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

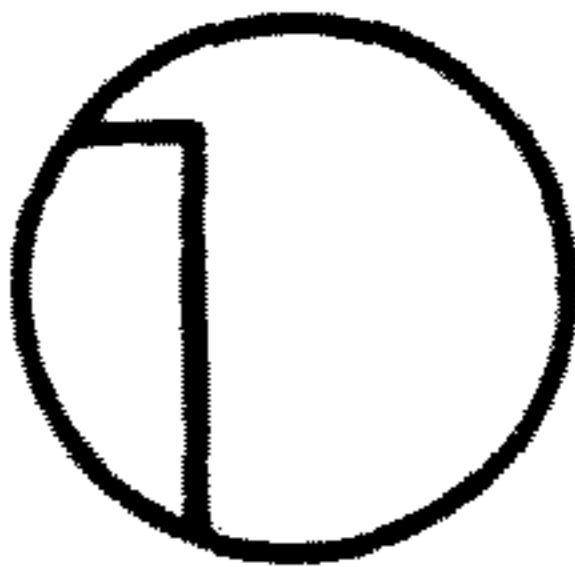
Условные графические обозначения приведены в таблице.

Наименование	Обозначение
Индикатор потока кислородный	
Индикатор потока кислородный поплавковый	
Индикатор потока кислородный флажковый	
Индикатор потока кислородный флажковый с манометром	
Разъем	
Разъединитель	

№ ИЗМ.  
№ ИЗВ.

Инв. № дубликата  
Инв. № подлинника  
5772

Продолжение

Наименование	Обозначение
Маска кислородная	
Шлем герметический	

№ ИЗМ.  
№ ИЗВ.

Инв. № дубликата  
Инв. № подлинника  
5772



## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изме- нения	Номер листа (страницы)				Номер доку- мента	Подпись	Дата внесе- ния изм.	Дата введения изм.
	изме- нен- ного	замене- нного	нового	аннули- рован- ного				

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

5772

**ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ № 10996**

ОСТ В1 00004-71

Группа 000

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ

Агрегаты кислородного оборудования

Листов 1

Лист

Для служебного пользования

Экз. № 69

*Дата введения*

1

июля 1989 г.

Стандарт отменить в связи с исключением из обозначения буквы "В".

Размножено по з/н № \_\_\_\_\_ Кол. экз. \_\_\_\_\_

Офсетная печать

Причина изменения

Указание о заделе

Шифр изм.

Исключение буквы "В"

Инвентарный №